


LDH test NAGATA をご利用された方へ


あなたの結果

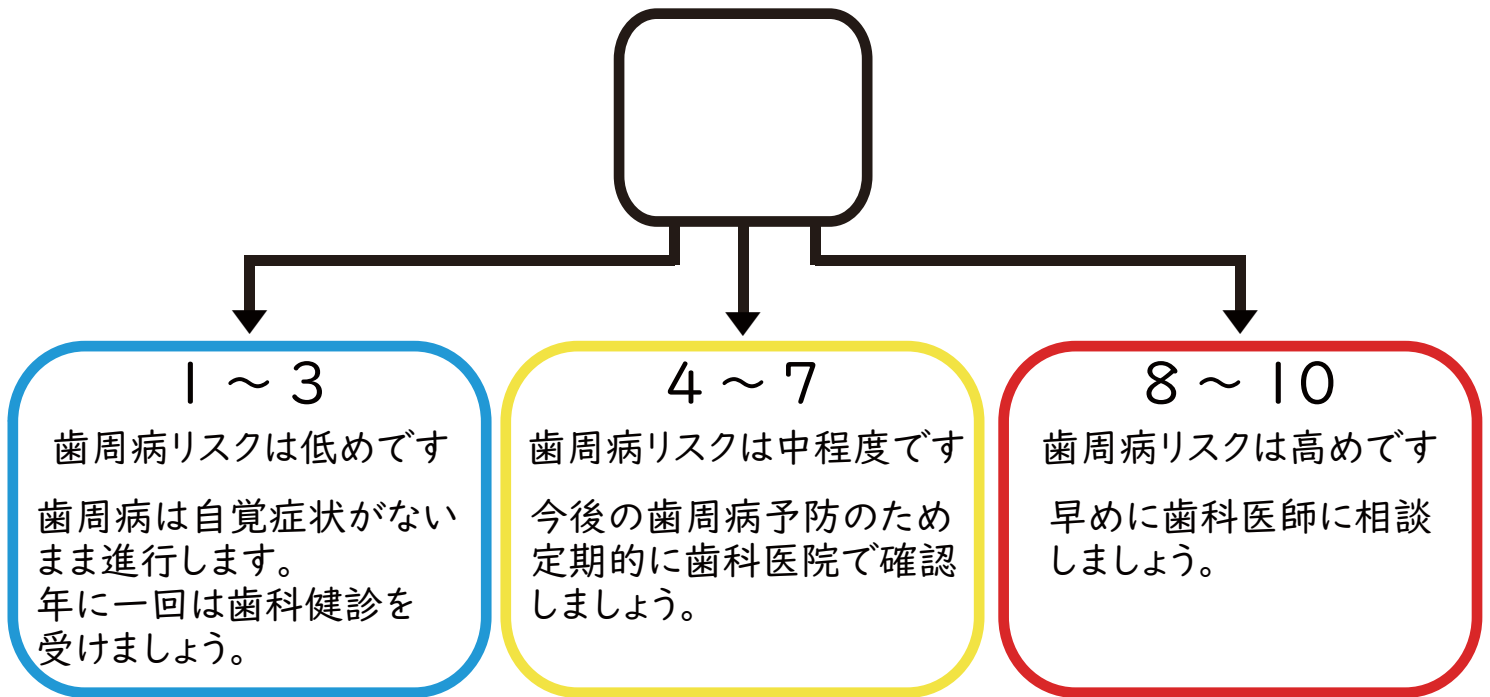

※本製品は体外診断用医薬品ではないため、歯周病を判定するものではありません。一般に、数値が1～3では歯肉にほとんど炎症が見られない可能性が高く、8以上では歯肉に炎症がある可能性が高いという目安になります。
※口内炎や口の中の粘膜に傷などがある場合には比色表の数値が高くなる場合があります。

LDH test NAGATA をご利用された方へ

あなたの結果

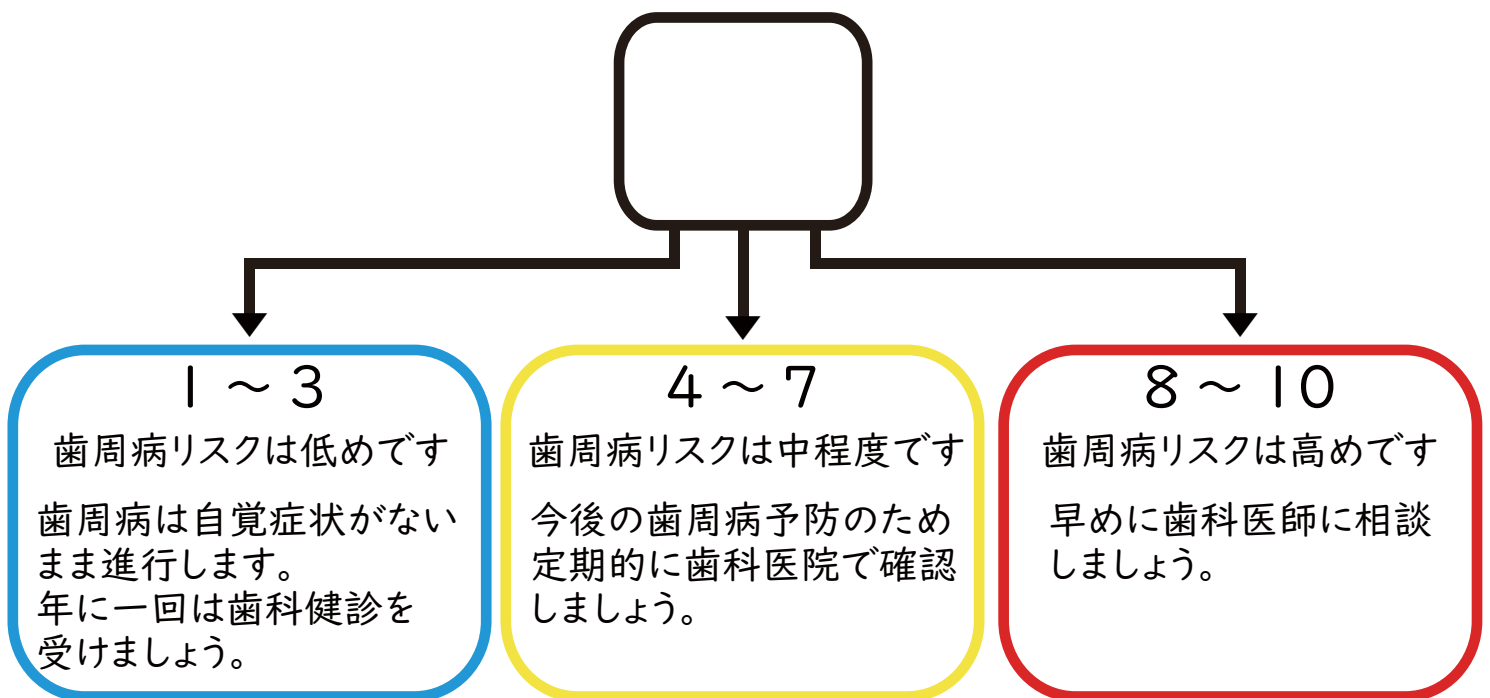

※本製品は体外診断用医薬品ではないため、歯周病を判定するものではありません。一般に、数値が1～3では歯肉にほとんど炎症が見られない可能性が高く、8以上では歯肉に炎症がある可能性が高いという目安になります。
※口内炎や口の中の粘膜に傷などがある場合には比色表の数値が高くなる場合があります。